HZ-10A

变压器 仪

产

品

书

兹 力 备 公司

赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力 HERTZ POWER

：

仪器在不使　情况下，　及　关　！

如　不使　仪器，　定　充、　，　应　少　充、　一　。

严　亏　使　，亏　将严　寿命，　使　废，当仪器　，应　上关　，　充　。　免因　导　失　。

充　：充　器上　充　在充　中亮　；充　完　后亮　。

不得　卸仪器并　，仪器　厂处　。

直阻测试			
电流档位	测量范围	电流档位	测量范围
500u Ω ～ 200m Ω		100mA	10 Ω ～ 200 Ω
10m Ω ～ 1 Ω		10mA	50 Ω ～ 2k Ω
100m Ω ～ 20 Ω		1mA	500 Ω ～ 50k Ω

10A	
5A	
1A	
技术指标	
准确度	
使用	
工作	

条件及外形	
电源	内置锂电池和外置充电器，充电器输入 100～240VAC，50Hz/60Hz

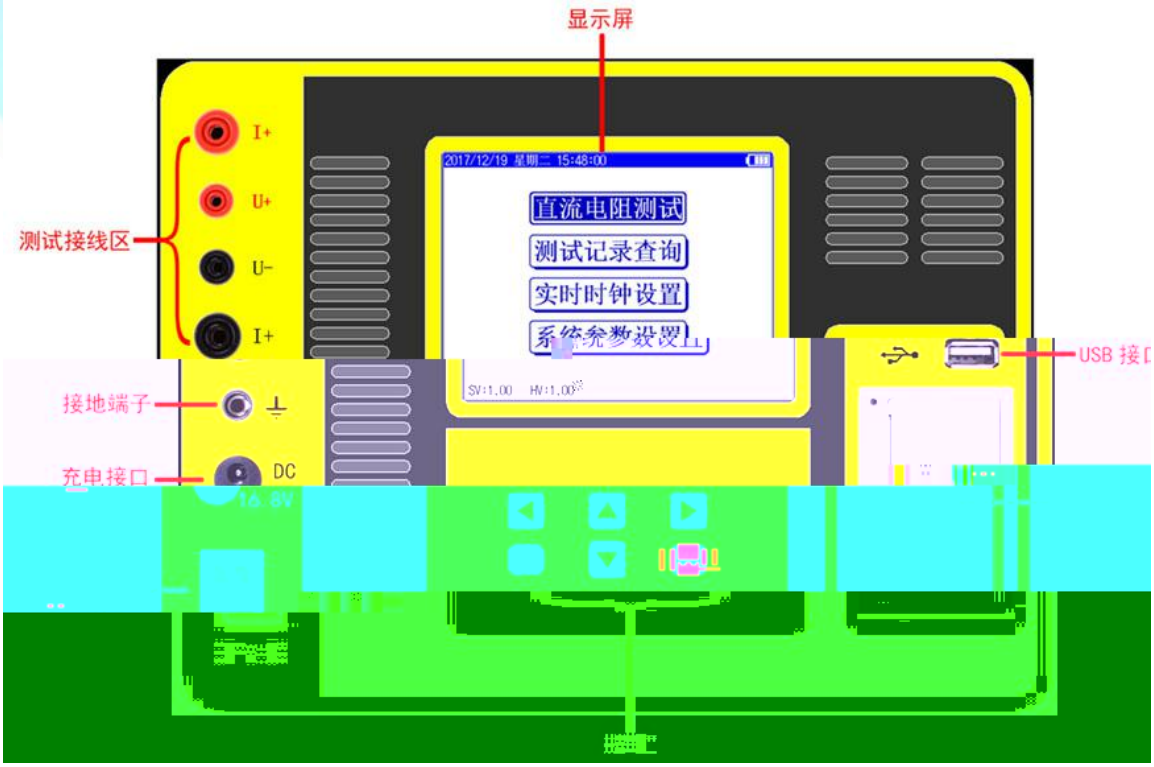

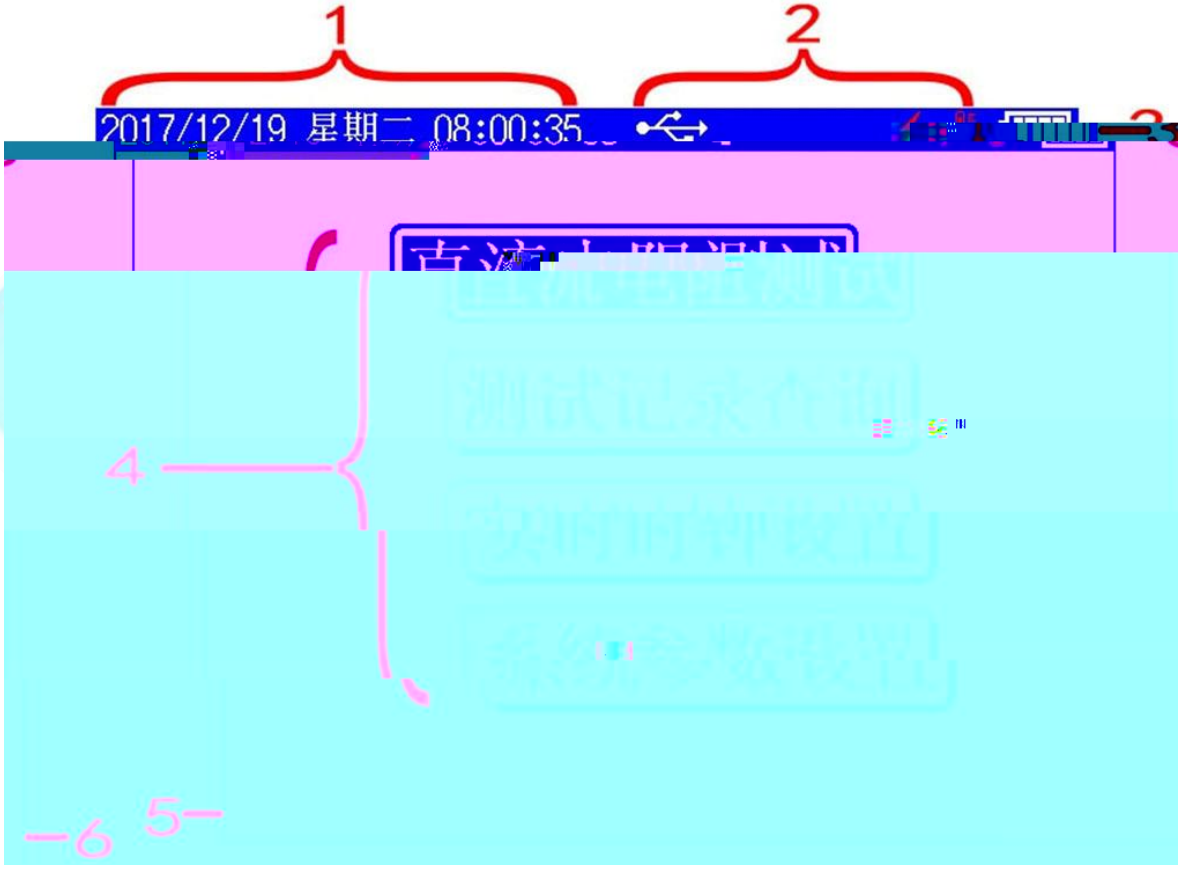
1
2
2017/12/19 星期二 08:00:35
3
4
5
6

赫兹电力 HERTZ POWER